


生産中止図面

2022/07

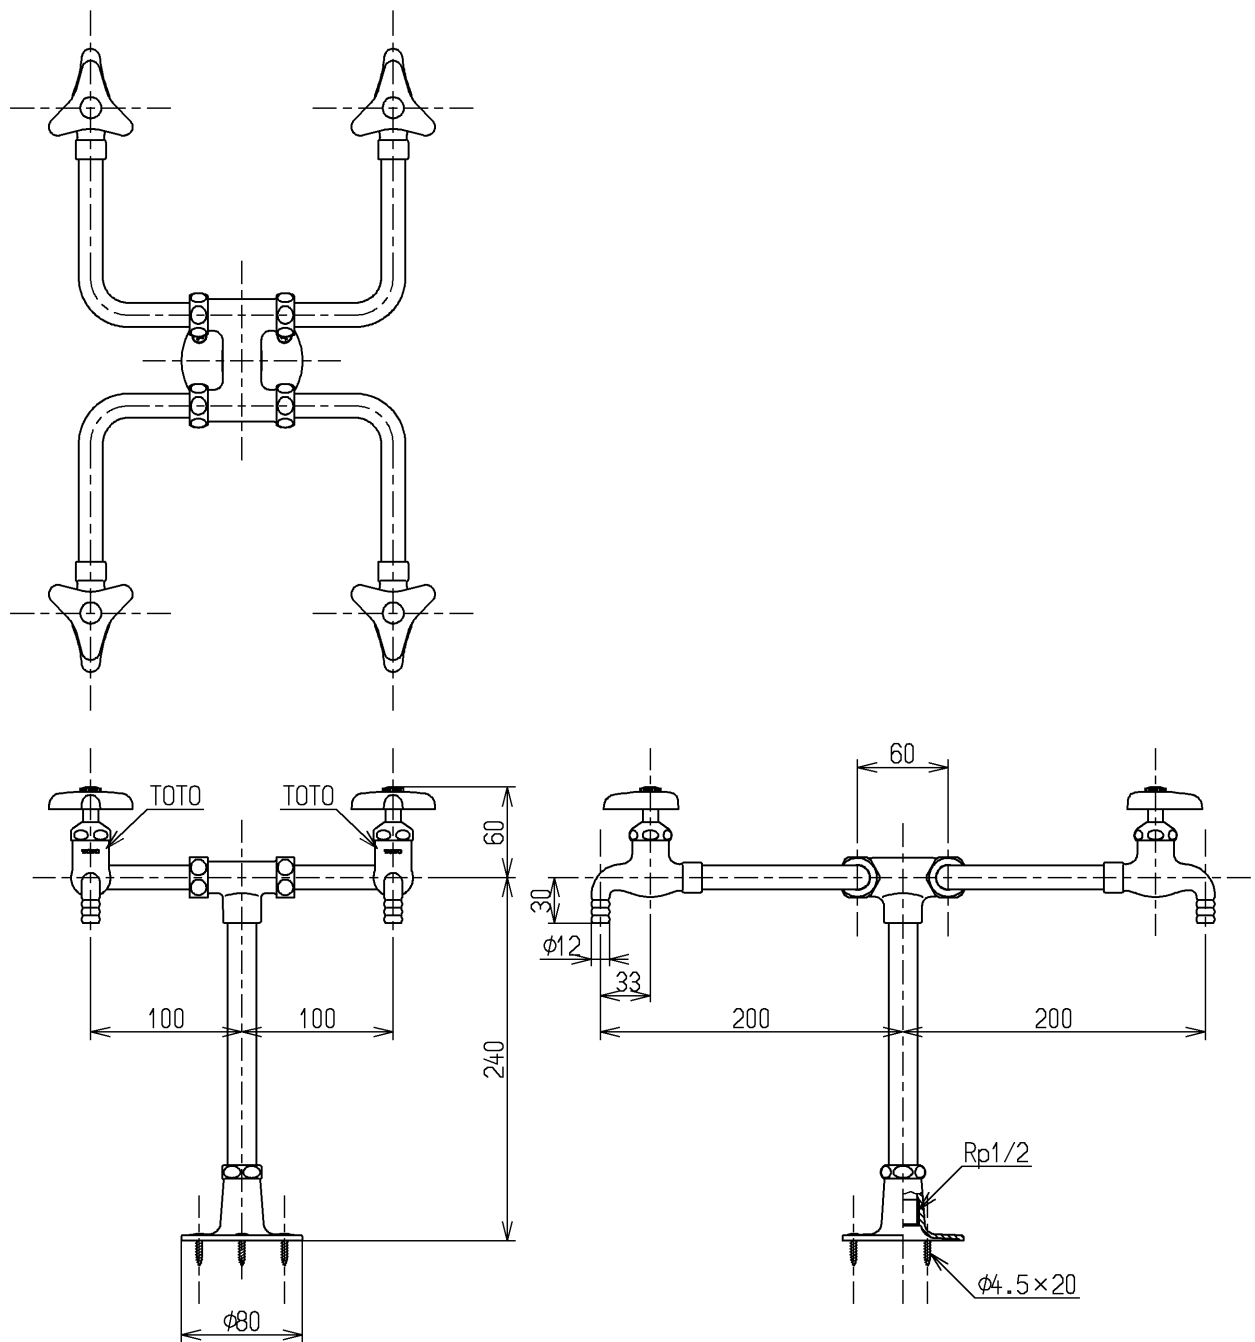

ガラス器具などの破損防止のため、吐水口先端に緩衝材（ホースなど）を取り付ける場合は、緩衝材（ホース）先端と実験用流しのあふれ縁との吐水口空間は、かならず2.5mm以上確保してください。吐水口空間が確保できないと逆流のおそれがあります

水道法適合品(JIS)

<b>TOTO</b>			単位 mm	名称 台付化学水栓
製図 宮園	検図 俵町	日付 松祐 尾 15.07.23	尺度 1:5	振分4口
備考				図番 T43D