


生産中止図面

2012/06

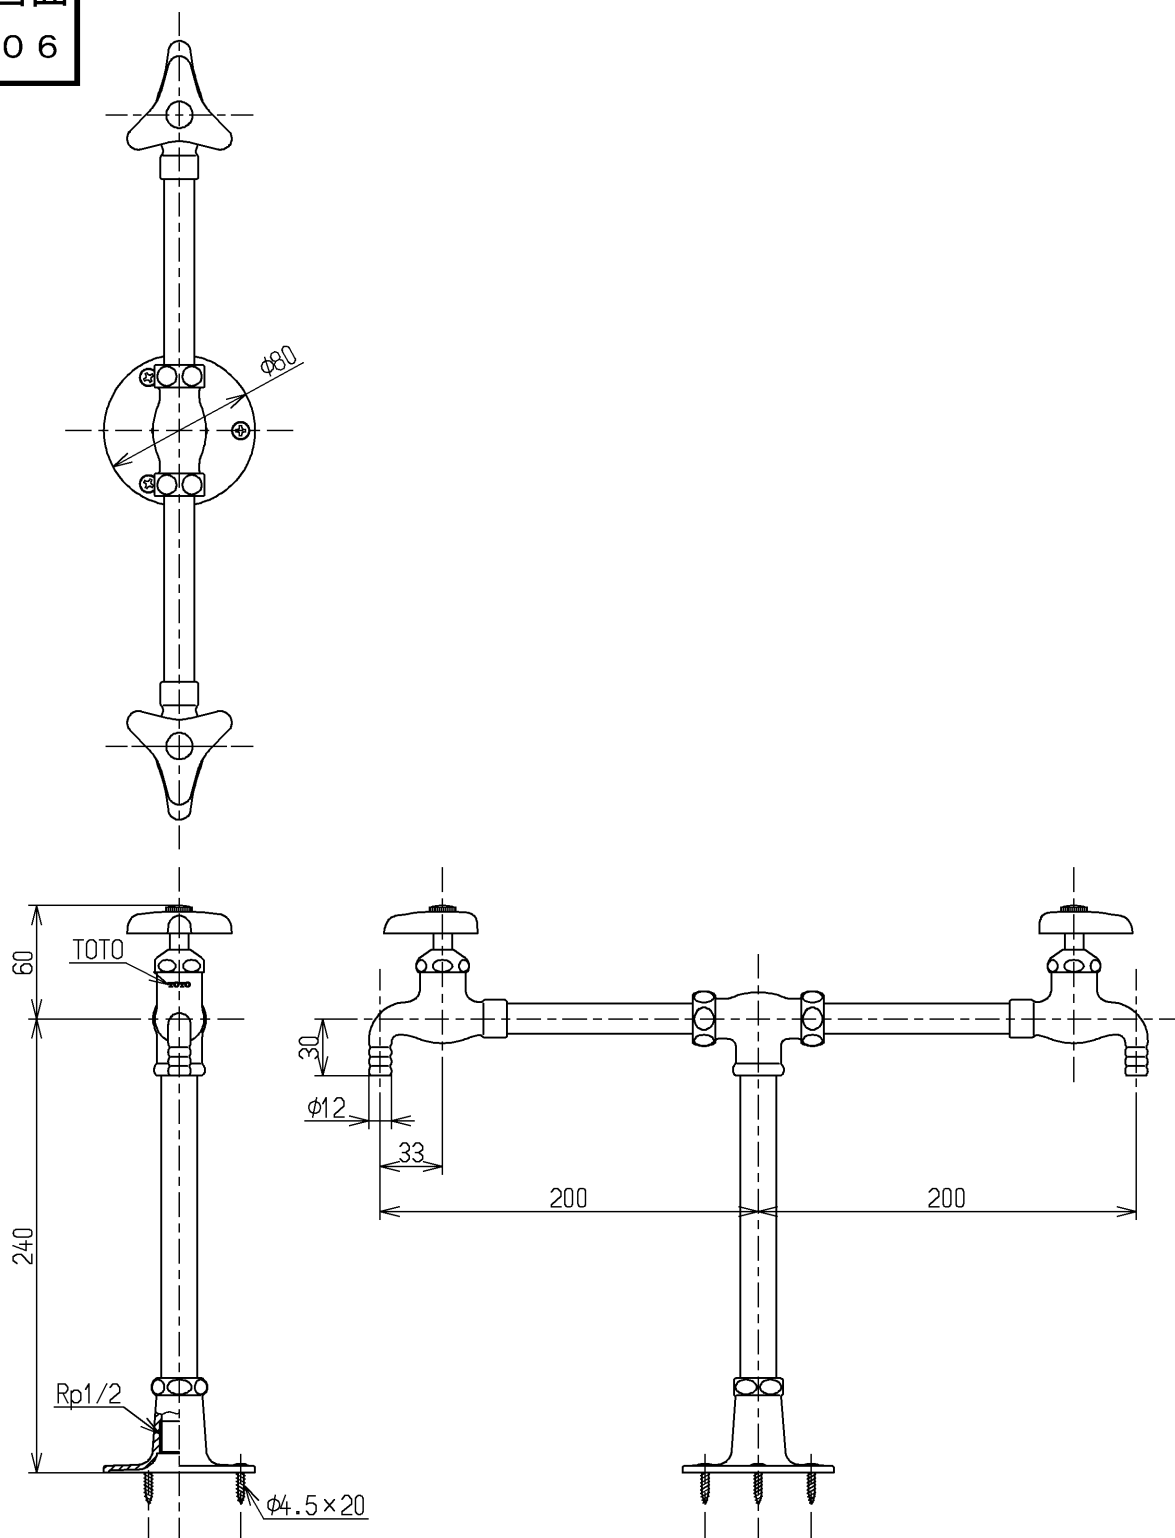

ガラス器具などの破損防止のため、吐水口先端に緩衝材（ホースなど）を取り付ける場合は、緩衝材（ホース）先端と実験用流しのあふれ縁との吐水口空間は、かならず25mm以上確保してください。吐水口空間が確保できないと逆流のおそれがあります

水道法適合品

<b>TOTO</b>			単位 mm	名称 台付化学水栓13 (振分2口) (JIS)
製図 和(照) 田	検図 本(忠) 田	日付 大(造) 12.06.28	尺度 1:4	図番
備考				T43B